

## 回流水槽

水流に対する物体の抵抗測定，流れ観察

### 【型式】


（株）西日本流体技研 V2-30B 型

### 【仕様】

測定領域 4×1.5×0.8m 流速 0～2.0m/s

### 【設置年度】

1992 年度（平成 4 年度）

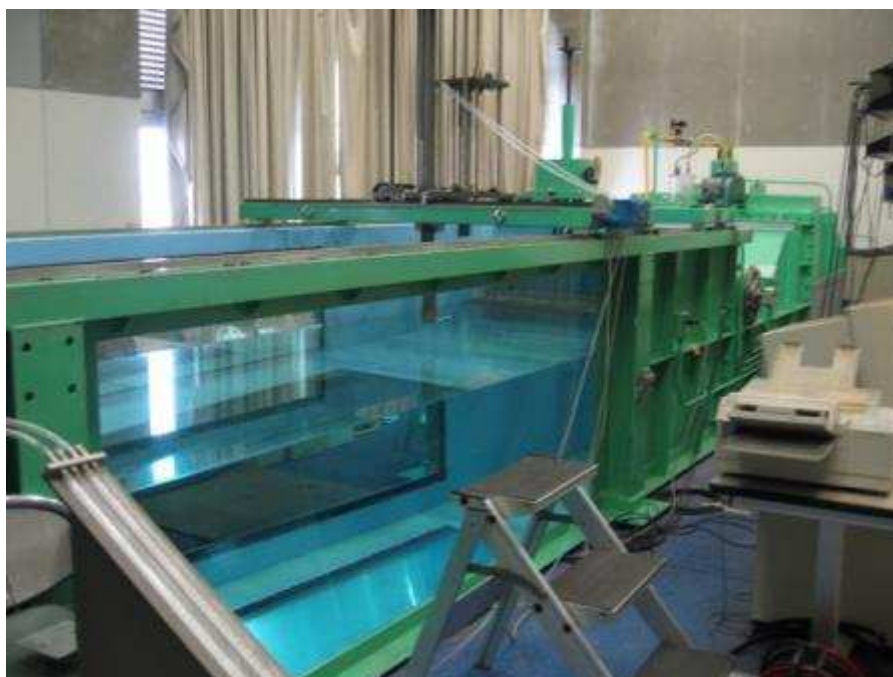

○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日